
HPLC

Sample Description:
Structure:COV6211
Lot NO.:P180612-LC488708
Number:0200193
Column:250*4.6mm,Boston Green ODS-AQ
Solvent A:0.1%TFA in 100%water
Solvent B:0.1%TFA in 100%acetonitrile

Gradient :	A	B
0.1min	75	25
25min	50	50
25.01min	0	100
30min	0	100

Flow rate:1.0ml/min
Wavelength(nm):220
Volume:10ul

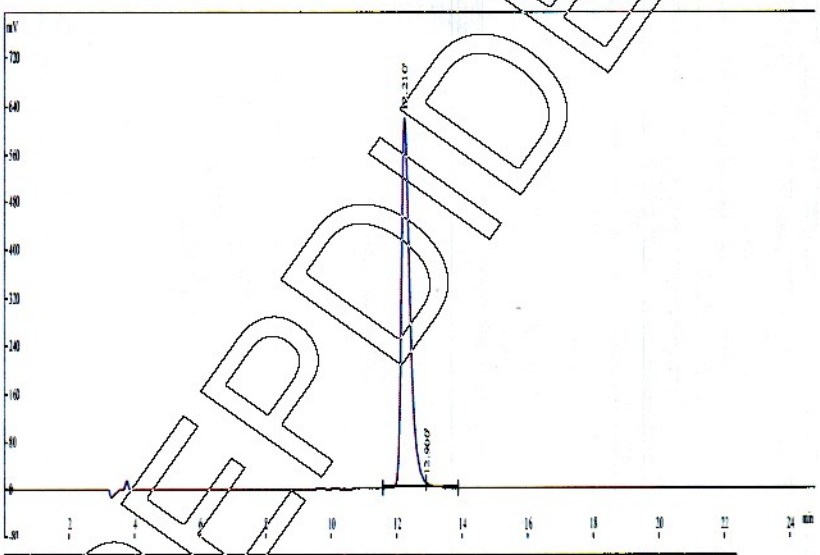


Rank	Time	Conc.	Area	Height
1	12.210	99.02	11382502	620977
2	12.906	0.9809	112755	7858
Total		100	11495257	628835

PUREPEPTIDESUK.COM

PUREPEPTIDESUK.COM

REPORT

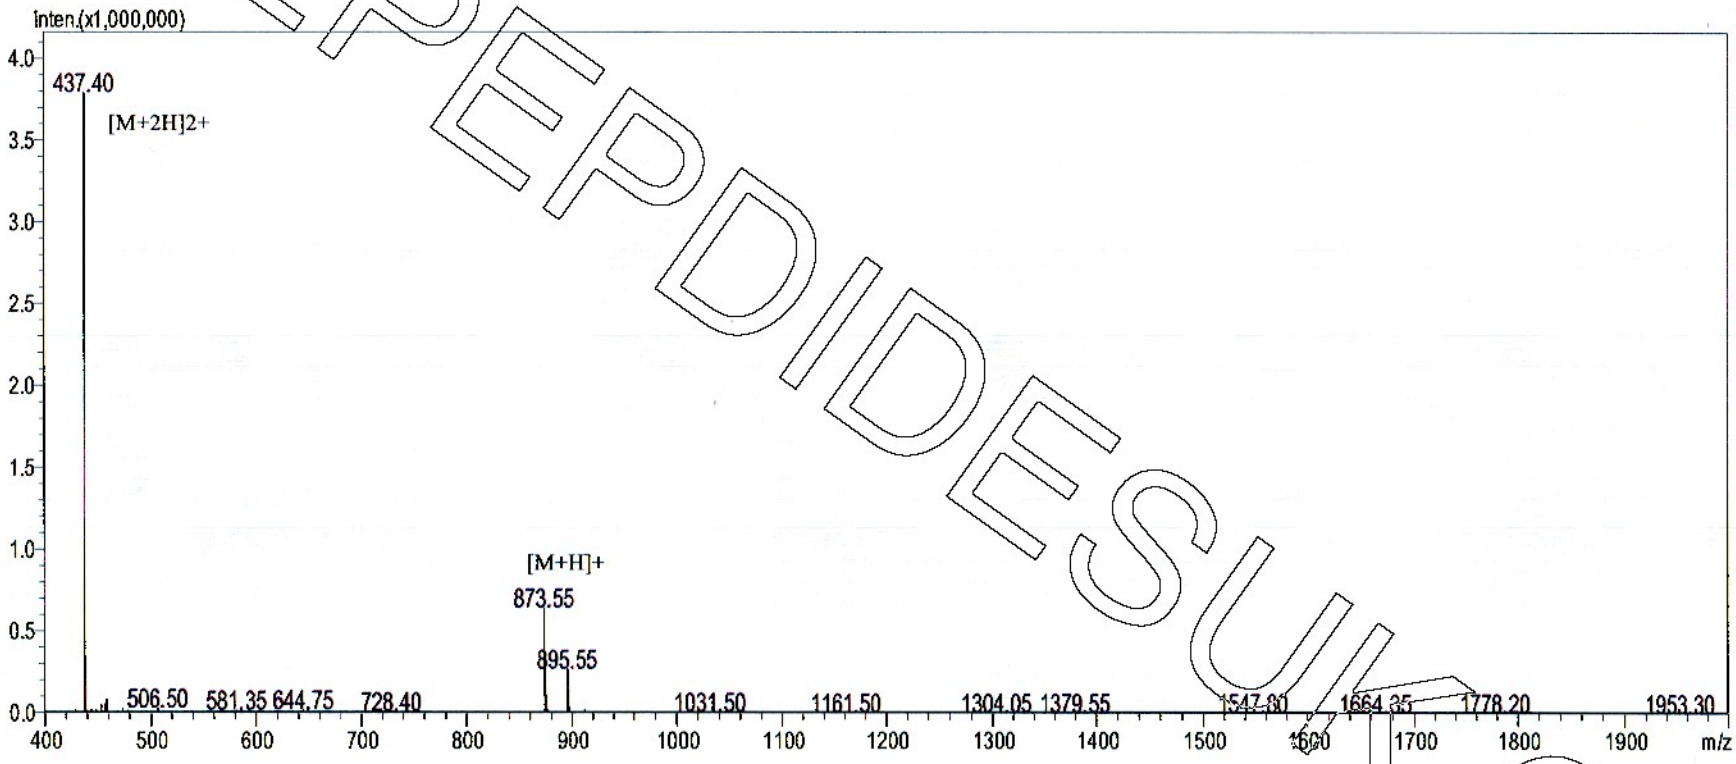

Date and Time:.2018-6-12 16:12:45

Sample :COV6211
MW :873.04
Lot No. : P180612-LC488708

Probe:	ESI	Probe bias:	+4.5kv
Nebulizer Gas Flow:	1.5L/min	Detector:	1.5kv
CDL:	-20.0v	T. Flow:	0.2ml/min
CDL Temp:	250℃	B. conc:	50%H2O/50%ACN
Block Temp:	200℃		