
HPLC REPORT

Structure : COV6374
Lot No : P181211-LC488709
Column : 4.6×250mm,Kromasil 100-5C18
Solvent A : 0.1% trifluoroacetic in 100% acetonitrile
Solvent B : 0.1% trifluoroacetic in 100% water
Gradient :

	A	B
0.01min	10%	90%
25min	35%	65%
25.1min	100%	0%
30min	STOP	


Flow rate : 1.0 mL/min
Wavelength : 220nm
Volume : 5ul

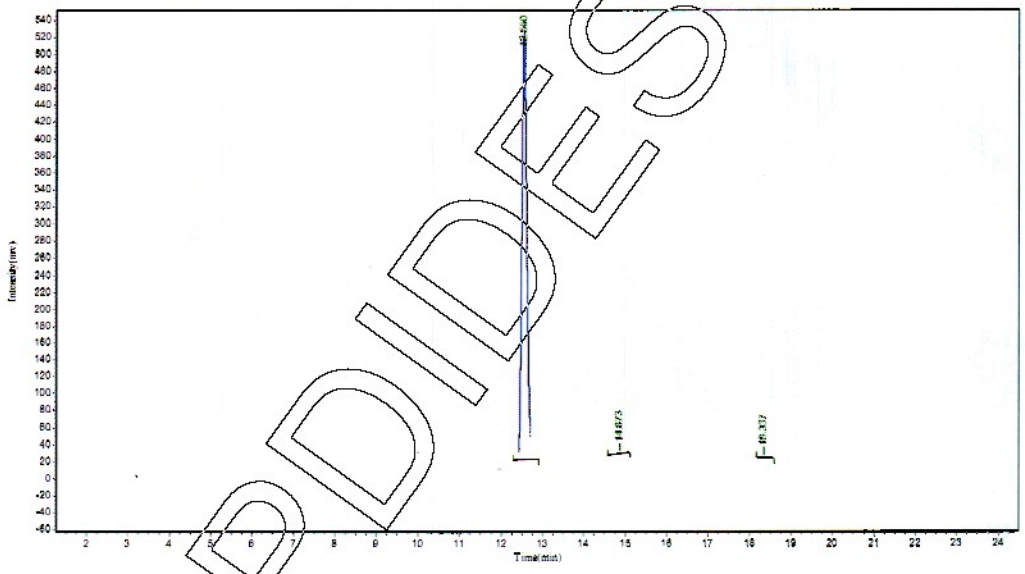

Peak No.	Ret Time	Height	Area	Conc.
1	12.530	508483.438	4212178.500	98.2431
2	14.873	2854.574	48016.633	1.1199
3	18.337	2308.719	27308.498	0.6369
Total				100.0000

PUREPEPTIDESUK.COM

PUREPEPDIDESUK.COM

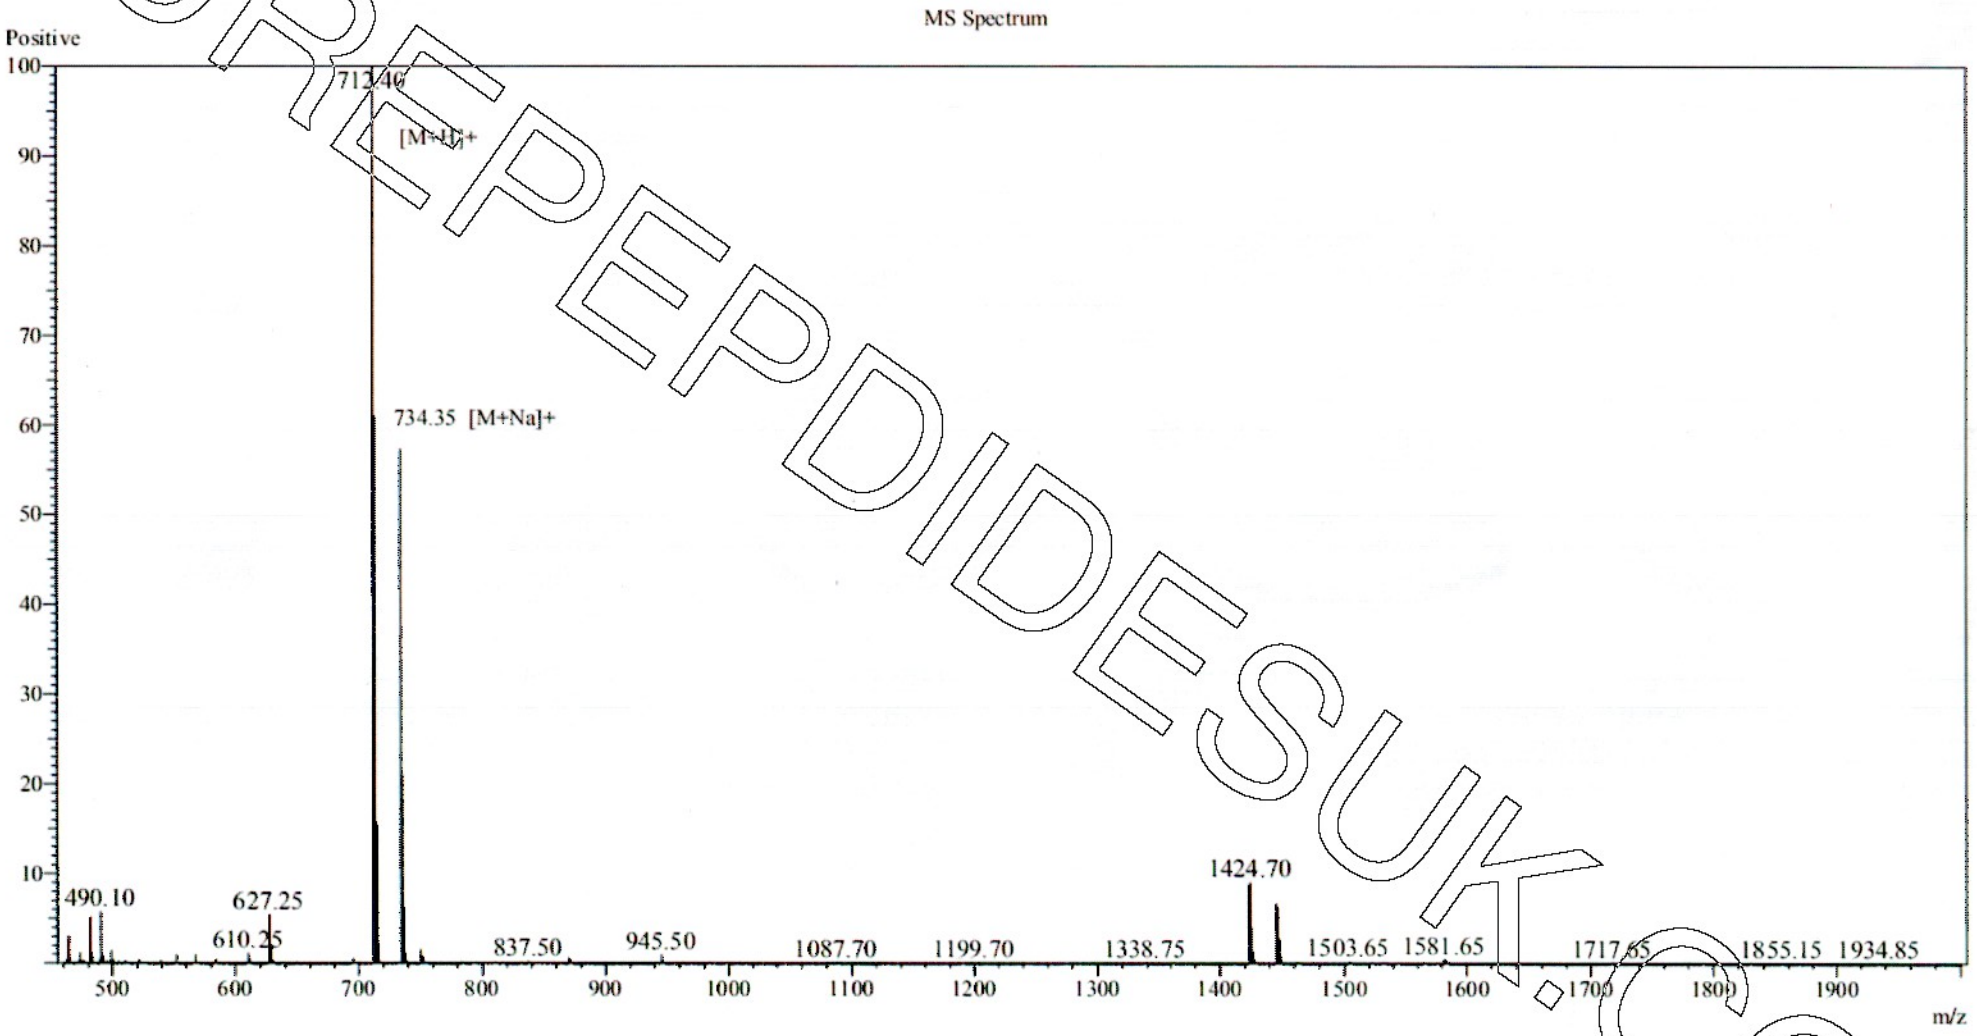

Data Acquired : 201812.11 13:24:07
Injection Volume : 1
Sample Name : COV6374
Mw : 711.86
Lot No. : P181211-LC488709

Probe	:ESI	Probe bias	:+4.5kv
Nebulizer Gas Floe	:1.5L/min	Detector	:2.0kv
CDL	:-20.0v	T.Flow	:0.2ml/min
CDL Temp	:250℃	B.conc	:50%H2O/50%ACN
Block Temp	:200℃		